

長野県外来医療計画に係る取組について

長野県外来医療計画に係る取組状況(1)


○ 外来医療機能に関すること

- ・ 県は医療機関(無床診療所)に対し、地域で不足する外来医療機能を担うことについての意向を確認。
- ・ 意向確認は医療機関が開設手続きを行う際、保健福祉事務所(保健所)に届出を提出することで行う。
- ・ 届出状況については、圏域ごとの協議の場(地域医療構想調整会議)へ報告。

【意向確認の対象となる医療機能】

- ①初期救急医療 ②在宅医療 ③公衆衛生に係る医療 ④その他、協議の場で不足すると認められた医療

【手続きフロー】

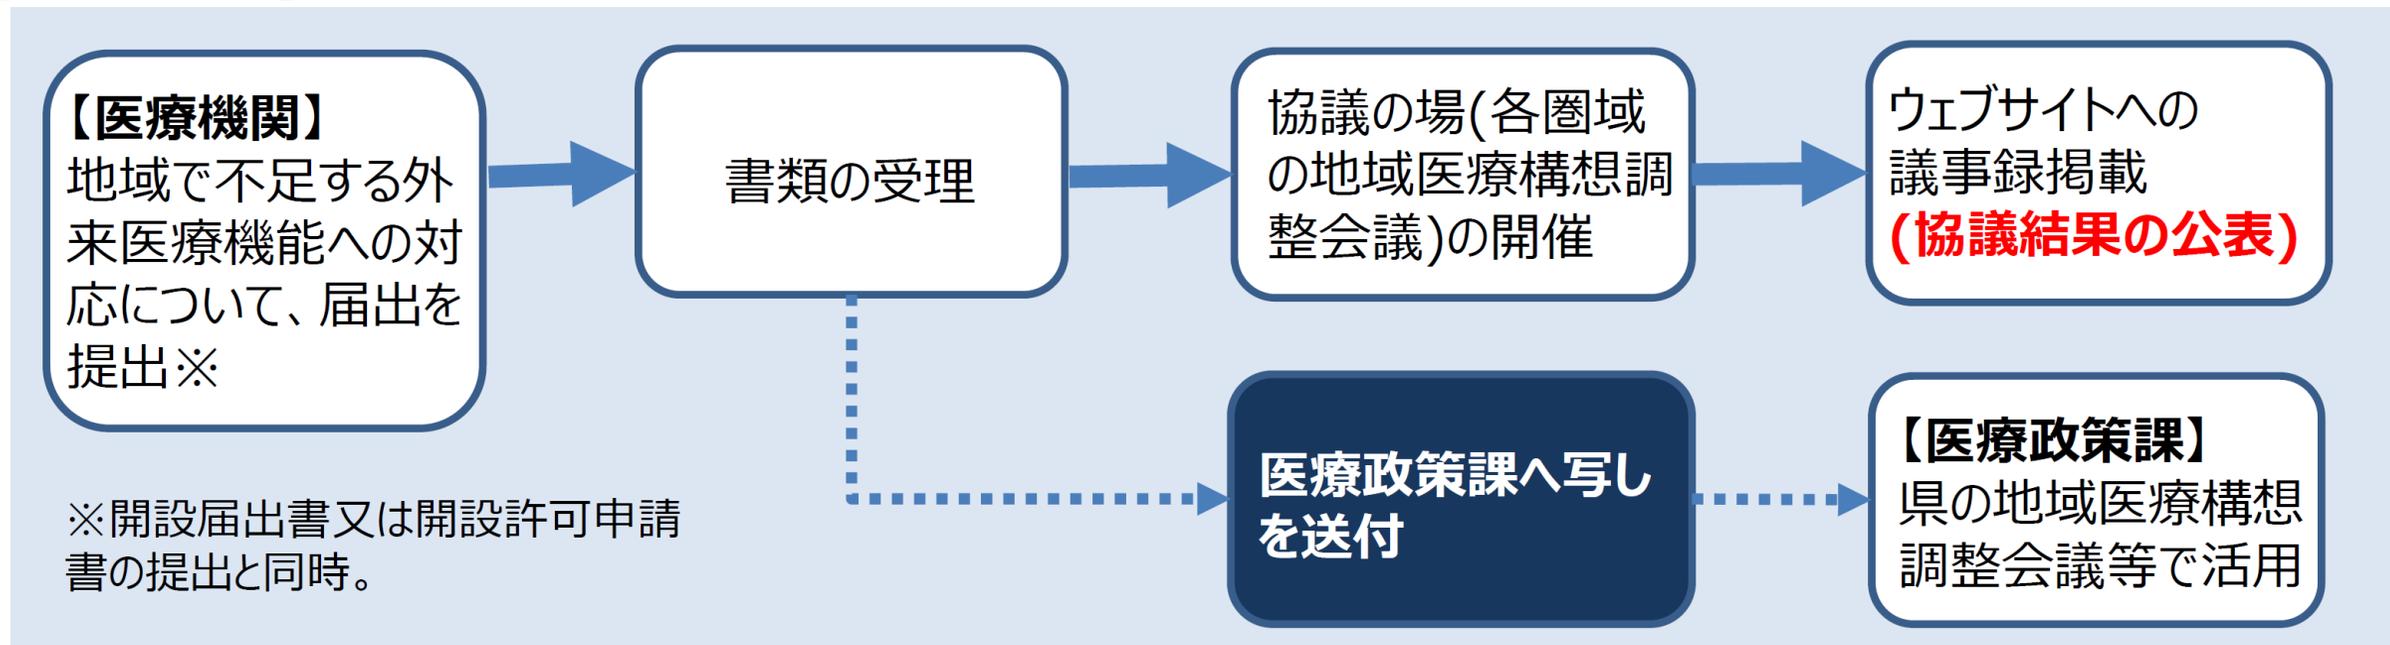

長野県外来医療計画に係る取組状況(2)


○ 医療機器の共同利用に関すること

- ・ 県は、外来医療計画に定める医療機器を新たに設置又は更新する医療機関に対し、共同利用の意向を確認。
- ・ 意向確認は、医療機関が機器の設置から10日以内に保健福祉事務所(保健所)に届出を提出することで行う。
- ・ 届出状況については圏域ごとの協議の場(地域医療構想調整会議)へ報告。

【共同利用計画の対象となる医療機器】

①CT ②MRI ③PET(PET-CTを含む) ④マンモグラフィ ⑤放射線治療機器(リニアック、ガンマナイフ等)

【手続きフロー】

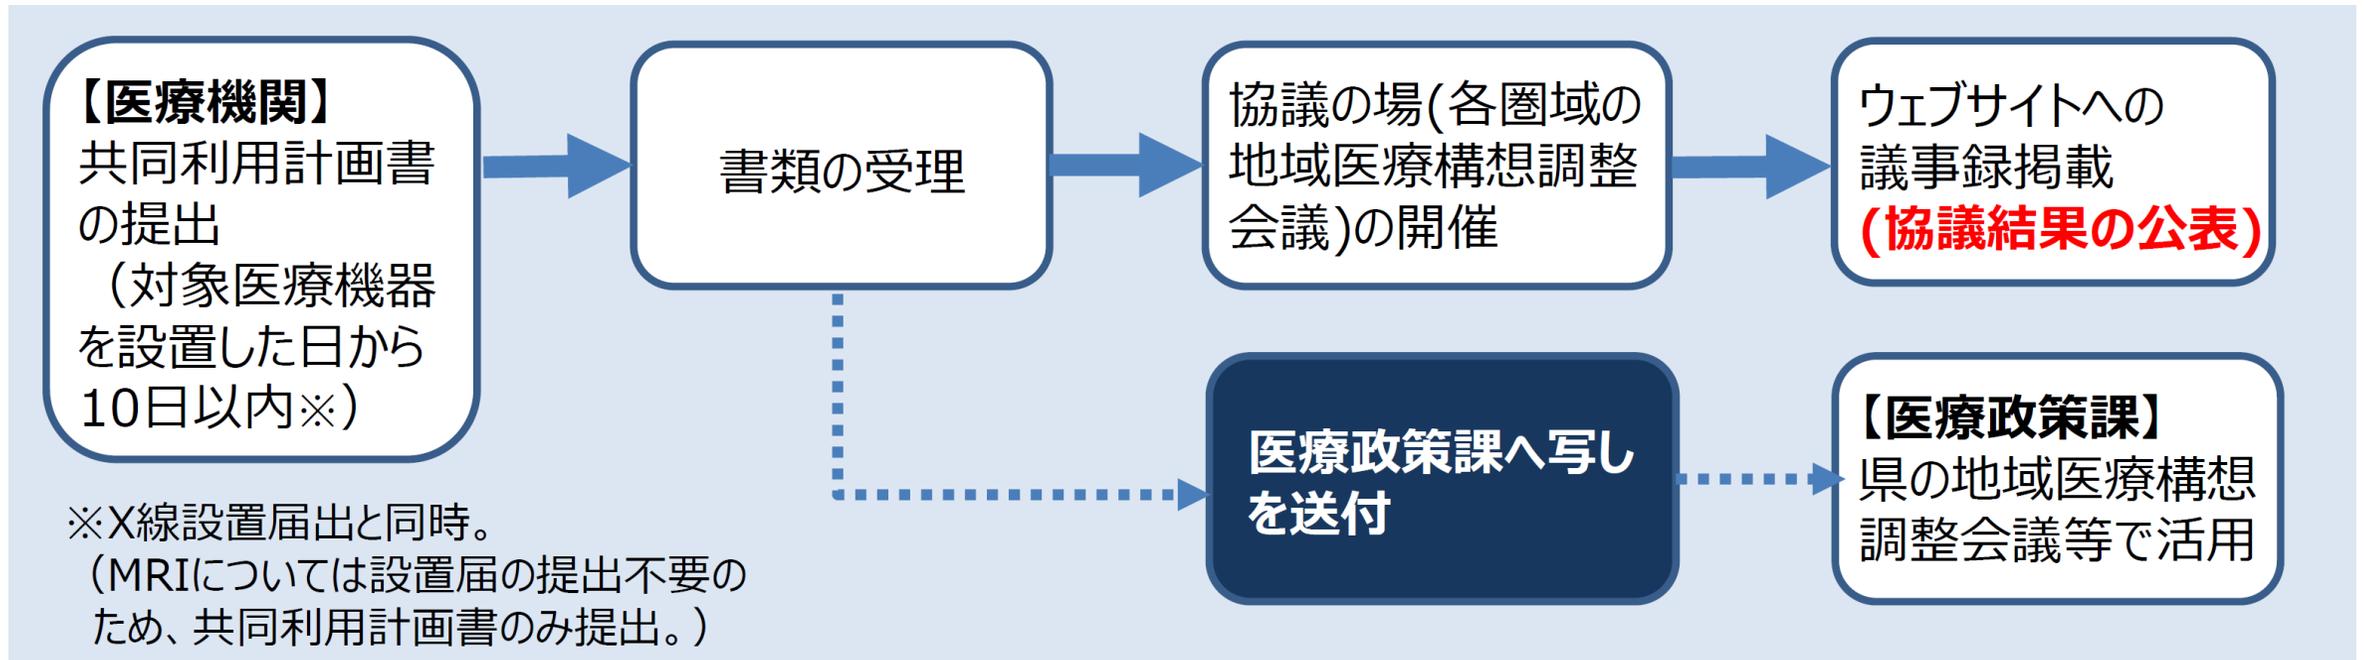

地域で不足する外来医療機能への対応状況

圏域	届出日	開設者	施設名	対応可能な医療				
				初期 救急	在宅 医療	公衆 衛生	その他	その他の内容
諏訪	R2.4.7	菅原 秀典	すがわら小児クリニック				○	小児外来医療、小児への予防接種
諏訪	R2.4.14	涌井 史典	皮フ科わくいクリニック	○	○	○		
上小	R2.6.16	竹内 さつき	桜の丘こどもクリニック	○		○	○	小児外来医療
佐久	R2.7.15	金山 浩信	かるいざわ御影用水クリニック				○	精神科・心療内科
佐久	R2.8.21	八木 絵里子	みさと皮フ科クリニック			○		
上小	R2.10.8	菅原 崇博	すがわら整形外科クリニック	○		○		
上小	R2.11.27	泉 従道	室賀診療所	○	○	○	○	
上伊那	R2.12.15	山田 香織	このはなクリニック	○				
長野	R2.12.8	金児 泰明	かねこ医院	○		○		
長野	R2.12.21	福嶋 敏信	福嶋メンタルクリニック戸倉					
長野	R2.12.8	甲田 隆	こうだ内科	○		○		
長野	R2.12.8	小橋 芳浩	あおぞら整形外科クリニック	○			○	
松本	R2.10.1	佐藤 ふみ	烏川脳神経外科	○		○		
松本	R2.8.6	池田 修一	いけだ内科・脳神経内科クリニック	○				
松本	R2.4.13	前澤 秀彦	前澤医院	○	○	○		
松本	R2.4.13	御子柴 育朋	みこしば皮膚科医院	○				
松本	R2.5.13	神谷 仁	ユーインケアクリニック			○		
松本	R2.12.13	薄井 雄企	うすいクリニック			○		
松本	R2.12.28	松本歯科大学病院 前島 信也	二條皮ふ科クリニック				○	地域で不足とされた皮膚外来医療

医療機器の共同利用計画書提出状況

圏域	1. 医療機器の情報			2. 設置する医療機器			3. 共同利用の実施について										
	届出日	開設者	施設名	区分	機器の種類	メーカー及び型式	設置年月日	共同利用	共同利用の方法			保守・整備の実施方針	CD DVD	紙	ネット ワーク	その他	
									相手方による機器の利用	相手方からの患者受入、画像情報等の提供	その他						
飯伊	R2.12.17	社会医療法人健和会 理事長 牛山 雅夫	健和会病院	更新	MRI (1.5テスラ以上3テスラ未満)	富士フィルムメディカル Amulet Innovality	R2.5.25	行う			○		点検2回/年 漏洩線量検査2回/年	○		○	
飯伊	R2.12.17	社会医療法人健和会 理事長 牛山 雅夫	健和会病院	更新	マンモグラフィ	(株)フィリップスエレクトロニクスジャパン Ingenial.5T CK	R2.9.3	行う			○		点検2回/年	○		○	
長野	R2.12.11	医療法人五公会 理事長 五明 広樹	ごみょう整形外科クリ ニック	更新	マルチスライスCT (16列以上64列未満)	GEヘルスケア・ジャパン(株) RevolutionACT	R2.4.1	要望があれば対応可		○	○			○			
長野	R2.12.15	医療法人公仁会 理事長 轟 勲	轟病院	更新	マルチスライスCT (64列以上)	キャノンメディカルシステムズ TSX-036A/9V	R2.11.9	行う			○		メーカーによる定期保守点検	○		○	
上小	R2.12.25	医療法人日比優一クリ ニック	日比優一クリニック	新規 購入	マルチスライスCT (16列以上64列未満)	キャノン Aquilion	R2.12.5	要望があれば対応可			○			○			